



Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ул. III Интернационала, д. 7, г. Ульяновск, 432063

тел.: 8 (422) 32-32-46, факс: 8 (422) 32-58-62

E-mail: regmed.uokb@yandex.ru

ОКПО 01948865, ОГРН 1027301409123,

ИНН 7300000043/КПП 732601001

1d 03 20 18 г. № 513

Президенту ассоциации
акушерских анестезиологов,
д.м.н., профессору Шифману Е.М.

Уважаемый Ефим Муневич!

По итогам II съезда Ассоциации акушерских анестезиологов – реаниматологов и II Пленума Правления Ассоциации ААР направляем Вам сканы с упаковок компонентов крови с указанием пола донора.

В результате совместной работы ГУЗ УОСПК (Ульяновская Областная станция переливания крови) и перинатального центра ГУЗ УОКБ (Ульяновская Областная клиническая больница), в декабре 2017 г., в программное обеспечение внесены изменения, позволяющие указывать пол донора на упаковке компонентов крови.

В настоящее время это касается эритроцитсодержащих препаратов, т.к. свежемороженая плазма маркируется и выдается только после полугодовой карантинизации.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Главный врач ГУЗ УОКБ

Дегтярь П.С.

Зам. Главного врача по акушерской
и гинекологической помощи

Галкина О.Н.

Зав. ОАР


Козлов А.В.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

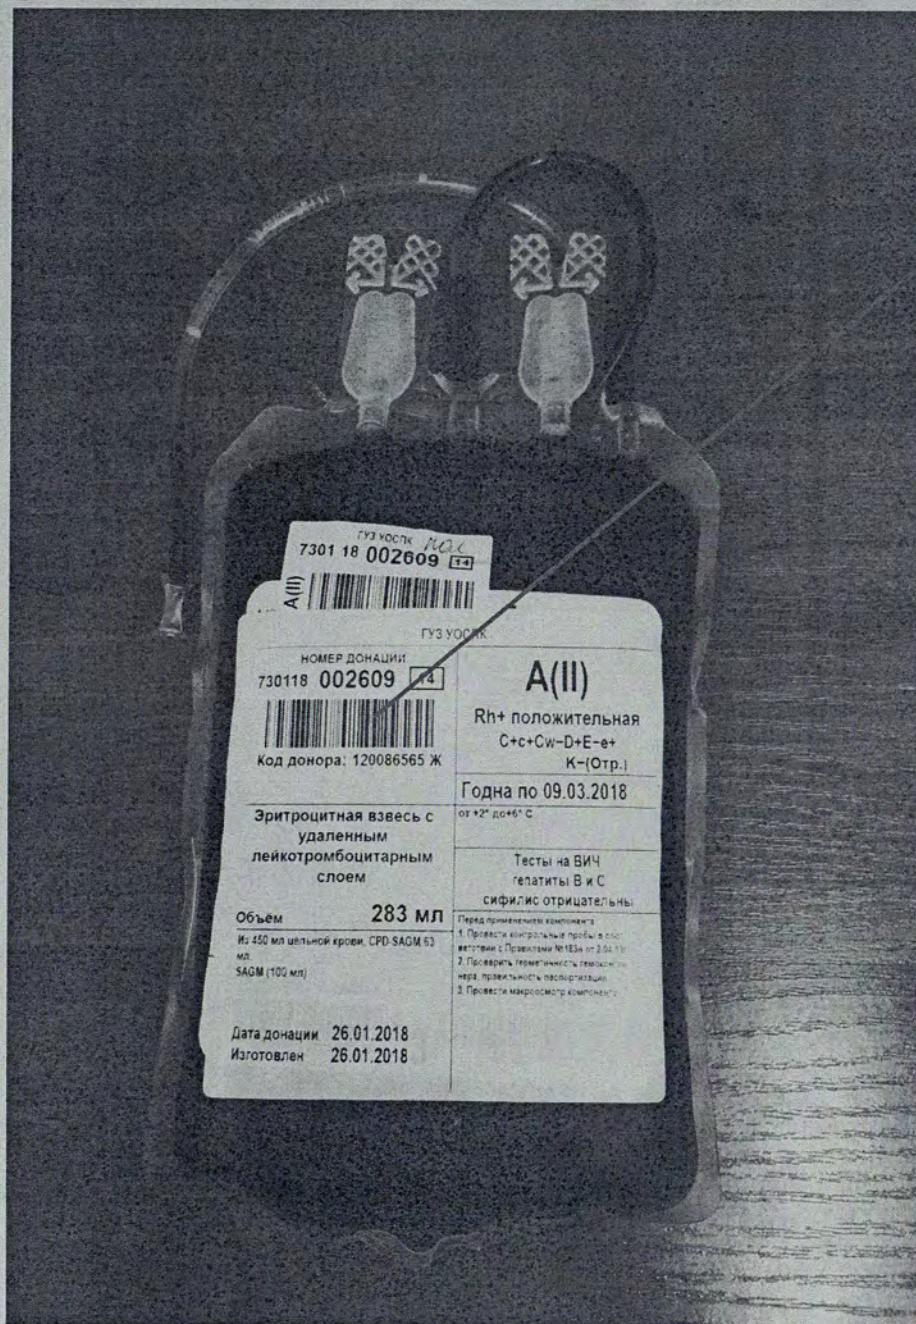

НОМЕР ДОНАЦИИ
730118 002609 14



Код донора: 120086565 Ж

густость *нкл*
730118 002609 14
A(II)

НОМЕР ДОНАЦИИ
730118 002609 14
Код донора: 120086565 Ж

A(II)
Rh+ положительная
C+c-Sw-D+E-e+
K-(Отр.)

Годна по 09.03.2018
от +2° до +6° C

Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитарным слоем

Тесты на ВИЧ гепатиты В и С
сифилис отрицательны

Объем **283 мл**
И: 450 мл цельной крови, CPD-SAGM 63 мл
SAGM (100 мл)

Дата донации 26.01.2018
Изготовлен 26.01.2018

Перед применением компонентов:
1. Проверить целостность герметичности и соответствие с Протоколом №1234 от 2.04.10
2. Проверить герметичность гемостатического клапана, правильность маркировки
3. Проверить маркировку компонентов